



MODULO RICHIESTA ACQUISTO

BENE / SERVIZIO / APPARECCHIATURA

NON DI RILEVANZA ATS e per importo, in ragione d'anno, inferiore a € 40.000 (IVA esclusa)

(Rif. Tabella 3 allegata alla Deliberazione D.G. ATS n° 800 del 15/06/2018)

**Alla Direzione P.O.U.O. "San Francesco" di Nuoro
Alla Direzione Servizio Farmaceutico Ospedaliero**

Oggetto: **Richiesta d'acquisto per materiale consumabile delle macchine lavastumenti di nostra proprietà.**

N.B.: ai fini della privacy (dati sensibili) non indicare mai estremi anagrafici di assistiti/destinatari richiesta (solo nome e iniziale cognome)

1) SERVIZIO / STRUTTURA / U.O. RICHIEDENTE: BLOCCO OPERATORIO

2) DIRETTORE / RESP. STRUTTURA RICHIEDENTE: D.SSA GRAZIA CATTINA

3) per esigenze del suddetto Servizio/U.O., si chiede la fornitura dei seguenti beni/servizi (barrare parte di non interesse) e a tal fine si dichiara che **non vi sono procedure di gara aggiudicate/contratti attivi ARES/ASSL**, che quanto richiesto **non è reperibile nei magazzini aziendali** (economici, farmaceutici, protesici, ecc.) e/o **non risulta disponibile presso il Servizio di Ingegneria Clinica**:

4) Trattasi di richiesta di acquisto tipologia BENE / SERVIZIO EX D.P.C.M. 24/12/2015 sì no

| Quantità | Codice AREAS | Referenza | RDM/CND/REPERTORIO | Descrizione/caratteristiche tecniche oggetto richiesta (allegare documentazione specifiche tecniche) |
|----------|--------------|------------|-------------------------|--|
| 30 | | 6001692431 | CND D0801 RDM 425593 | DETERGENTE UNIVERSALE tanica da 5L. |
| 15 | | 503435831 | CND V9099 RDM 424814 | NEUTRALIZZANTE tanica da 5L. |
| 10 | | 503436231 | CND V9099 RDM 424956 | LUBRIFICANTE tanica da 5L. |
| 30 | | LIT-05613 | CND D99 RDM 445129 | DECONEX ANTISEPTIC tanica da 5L. |
| 120 | | 570435502 | CND NA RDM NA | Carta termica stampante Martel in rotolo |
| 10 | | LIT-05450 | CND NA RDM NA | Sale per addolcitore, sacco da 25 kg |

Ai fini dell'individuazione dell'esatta competenza dell'acquisto, la suddetta richiesta deve obbligatoriamente ricadere nelle fattispecie di seguito indicate:

a) In primis, il bene/servizio/apparecchiatura **NON deve essere di rilevanza ARES (se di rilevanza ARES la richiesta deve essere preventivamente trasmessa alla Direzione ASSL Nuoro che disporrà per l'inoltro alle competenti strutture ATS, ovvero: SC Acquisti Beni (per tutti i beni), SC Acquisti Servizi Sanitari (per servizi sanitari), SC Acquisti Servizi Non Sanitari (per i servizi non sanitari), SC Ingegneria Clinica (per le apparecchiature/attrezzature elettromedicali/biomedicali), Dipartimento Farmaco ARES.**

b) Qualora **NON SIA RILEVANZA ARES**, il bene/dispositivo/apparecchiatura, ecc. richiesto deve avere un costo presunto di **IMPORTO ANNUO inferiore a € 40.000 (IVA esclusa)**

N.B.: Specificare, **obbligatoriamente**, quantità, codice AREAS, CND/RDM/REPERTORIO

5) Trattasi di bene **DEDICATO/UNICO/INFUNGIBILE**, ex Art. 63, c. 2, lett. b), del D. Lgs. n° 50/2016 sì no

In caso affermativo specificare DITTA GETINGE e relativo COD. **PRODOTTO: MACCHINE LAVASTRUMENTI GETINGE GE/WD 15 CLARO DI NOSTRA PROPRIETA'**

6) Richiesta per lotto unico sì no più lotti sì no

7) ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI: _____

8) COSTO PRESUNTO: circa € 13.000 circa _____

9) FABBISOGNO: MENSILE SEMESTRALE ANNUALE PLURIENNALE OCCASIONALE

10) CODICE/PROGETTO/FINANZIAMENTO: fondi di bilancio o altro strumento (specificare) _____

11) EVENTUALI ALLEGATI (nel rispetto della vigente normativa privacy) _____ SCHEDA TECNICA _____


Firma del Direttore Dipartimento/P.O./Servizio/U.O. (o suo Delegato)

_____ 

N.B.: Le Direzioni P.O.U.O. San Francesco di Nuoro e del Servizio Farmaceutico Ospedaliero per quanto di propria competenza qualora rilevino che la presente richiesta evidenzia la necessità di annotazioni e/o di elementi mancanti (da integrare/completare), provvederanno alla sua restituzione/integrazione/completamento al fini del buon esito stesso della richiesta.


PARTE RISERVATA ALLA Direzione P.O.U.O. San Francesco di Nuoro (Evidenziare eventuali note e/o elementi mancanti nella richiesta ai fini della restituzione/integrazione/completamento della richiesta, altrimenti esprimere parere favorevole).

Firma Direzione P.O.U.O. (o suo Delegato)

_____ 

PARTE RISERVATA ALLA DIREZIONE ASSL NUORO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO:

Firma del Direttore ASSL Nuoro

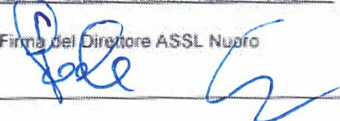
_____ 

Istruzioni per l'uso

deconex® ANTISEPTIC

Detergente disinfettante alcalino

Per l'impiego in macchina disinfettatrice/
lavadisinfettatrice (LD)



Settori d'impiego

deconex® ANTISEPTIC è un detergente, o meglio un detergente disinfettante, che può essere utilizzato nei processi RDG sia termici sia termo-chimici.

Il ricondizionamento termo-chimico con deconex® ANTISEPTIC riguarda dispositivi medici non critici, quali accessori per anestesia e ventilazione artificiale, strumenti da medicazione, quali forbici, pinzette, bacinelle, nonché materiali di adagiamento in elastomeri e plastica. Il prodotto è anche particolarmente indicato per il ricondizionamento di calzature ospedaliere realizzate in materiali compatibili.

deconex® ANTISEPTIC non è appropriato per la disinfezione finale di dispositivi medici semi-critici, quali ad esempio tubi endotracheali ed endoscopi flessibili.

Applicazione e dosaggio

Tabella di dosaggio per LD

Il dosaggio ottimale dipende dalla durezza dell'acqua e dal livello di sporco.
Nella pratica i seguenti dosaggi e le seguenti temperature hanno dato buoni risultati:

| Dosaggio | acqua dolce | acqua di media durezza | acqua dura | Temperatura |
|---------------------------------|-------------|------------------------|------------|---------------|
| deconex® ANTISEPTIC per pulizia | 3 mL/L | 5 mL/L | 7 mL/L | 70 °C |
| e disinfezione termochimica | 5 mL/L | 5 mL/L | 5 mL/L | 70 °C / 5 min |

Proprietà


- eccezionale forza pulente
- alcalino
- contiene tensioattivi
- privo di NTA
- ampio spettro d'azione nell'impiego per disinfezione termochimica
- comprovato effetto limitato contro i prioni
- buona compatibilità con i materiali
- non richiede neutralizzazione
- impedisce la formazione di depositi di silicati

Foglio illustrativo

deconex® ANTISEPTIC

Detergente disinfettante alcalino

Per l'impiego in in macchina disinfettatrice/
lavadisinfettatrice (LD)



Composizione chimica

Alcali
Agenti complessanti
Agenti anticorrosione
Agenti sequestranti
Sostanze tensioattive

Compatibilità con i materiali

Adatto per:
Acciaio inox, materiali cromati, alluminio, materie plastiche,
gomma, lattice, vetro, materie ceramiche

Concentrato:
Per la compatibilità con i tubi di trasferimento e le pompe peri-
staltiche richiedere la scheda informativa separata.

Per i materiali non indicati e le superfici in alluminio anodizzato
deve essere eseguita un'analisi di compatibilità direttamente
dal cliente o, su richiesta, da Borer Chemie AG.

Spettro d'azione

| Spettro d'azione | Metodologia | Concentrazione | Temperatura | Tempo d'azione |
|--|--|----------------|-------------|----------------|
| Azione battericida nella prova quantitativa a portatore di germi | secondo la norma EN 14561 (con carica ridotta) | 0.5 % | 70 °C | 5 min |
| Azione fungicida nella prova quantitativa a portatore di germi | secondo la norma EN14562 (con carica ridotta) | 0.5 % | 70 °C | 5 min |
| Azione micobattericida nella prova quantitativa a portatore di germi | secondo la norma EN14562 (con carica ridotta) | 0.5 % | 70 °C | 5 min |
| Efficacia antivirale: BPV (Parvovirus bovino) | Direttive DVV/RKI (con carica) | 0.5 % | 70 °C | 5 min |

Marchio CE

deconex® ANTISEPTIC soddisfa i requisiti previsti dalla Dire-
tiva CEE 93 / 42 sui dispositivi medici.

Perizia

deconex® ANTISEPTIC è stato esaminato per accertare la
sua efficacia a 70°C contro l'Enterococcus faecium secondo
la norma EN14561, contro la Candida albicans e l'Aspergillus
brasiliensis secondo la norma EN 14562, contro il Mycobacte-
rium terrae e il Mycobaterium avium secondo la norma EN
14563 e contro il Parvovirus bovino secondo le direttive DVV/
RKI. Le perizie sono disponibili su richiesta.

Getinge Clean

Universal Detergent

Detergente alcalino delicato impiegato nei termodisinfettori e nelle vasche a ultrasuoni, nonché per la pulizia manuale di strumenti chirurgici. Può essere utilizzato su superfici resistenti agli alcali come acciaio inossidabile, ceramica, vetro, materie plastiche e metalli soffici resistenti.



Istruzioni per l'uso

- Dosaggio: 2–10 ml/l
- Temperatura di lavaggio (automatico): 35–60 °C
- Temperatura di lavaggio (manuale/ultrasuoni): 30–45 °C.
- Assicurarsi di risciacquare bene dopo l'uso
- La neutralizzazione non è richiesta

Avvertenze

- Non utilizzare su materiale in polycarbonato
- Verificare la compatibilità con i materiali prima dell'uso
- Non mescolare con altre sostanze chimiche
- Indossare sempre DPI adeguati

Simboli



Tutti i materiali



Detergente



Strumenti di chirurgia robotica

Dati tecnici

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Gravità specifica (20 °C): | 1,09 (tipica) |
| pH tal quale (standard): | 11.0 |
| pH a 5 ml/l di acqua (standard): | >9.9 |
| Viscosità (concentrata, 20 °C): | 4,6 cSt |

Ingredienti

Enzimi, agenti sequestranti, inibitori di corrosione e tensioattivi.

Informazioni per lo stoccaggio

Conservare in un luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo, lontano da sostanze acide e forti ossidanti. Conservare il prodotto in posizione verticale nel suo contenitore originale. Temperatura di conservazione ottimale 5–25 °C. Durata di conservazione: 18 mesi in contenitori originali sigillati.

Sicurezza e manipolazione

Fare riferimento alla scheda di sicurezza.

MARCATURA CE

Contrassegnato dal marchio CE in conformità con i requisiti normativi europei vigenti sui dispositivi medici.

Assistenza

Per assistenza tecnica sul corretto utilizzo del detergente, contattare il rappresentante Getinge locale.

Coscienza ambientale

Formulazione biodegradabile e imballaggio riciclabile.

Codice prodotto

| Quantità (l) | Lingua | Codice prodotto | Commenti |
|--------------|--|-----------------|----------|
| 5 | en, sv, da, no, fr, de, nl, es, it, pt, tr, ru, zh, ja, el, cs, pl | 6001692431 | |
| 10 | sv, da, no, it | 6001692531 | |
| 10 | de, tr, es, pl | 6001692532 | |
| 10 | fr, nl, es, ja | 6001692533 | |
| 10 | en, ru, zh, el | 6001692534 | |
| 25 | sv, da, no, it | 6001692631 | |
| 25 | de, tr, cs, pl | 6001692632 | |
| 25 | fr, nl, es, ja | 6001692633 | |
| 25 | en, ru, zh, el | 6001692634 | |
| 205 | en, sv, da, no, fr, de, nl, es, it, pt, tr, ru, zh, ja, el, cs, pl | 6001692731 | |

Compatibilità dei materiali

Consultare sempre le istruzioni per la pulizia fornite dal produttore degli articoli e degli strumenti e verificare la compatibilità con i materiali prima dell'uso. La tabella che segue è puramente indicativa.

| | Alluminio | Alluminio anodizzato | Titanio | Metalli non ferrosi | Cromatura opaca | Acciaio inox | Vetro | Ceramica | Gomma | Plastica |
|---|-----------|----------------------|---------|---------------------|-----------------|--------------|-------|----------|-------|----------|
| Getinge Clean Universal Detergent | M | M | M | M | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | M |
| Getinge Clean Instrument Lubricant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Getinge Clean Instrument Lubricant Plus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Getinge Clean Pre Treatment Foam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Getinge Clean Enzymatic Detergent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | M |
| Getinge Clean Manual Plus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Getinge Clean MIS Detergent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Getinge Clean Prion Detergent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Getinge Clean Heavy Soil Detergent | - | - | M | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | M |
| Getinge Clean Rinse Aid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | M | M |
| Getinge Clean Chamber Foam | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - |
| Getinge Clean Neutralizer | M | M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | M | M |
| Getinge Clean Neutralizer Plus | - | - | M | M | M | ✓ | - | M | M | M |

008070

✓ = Il prodotto è adatto per il materiale

- = Il prodotto non è adatto per il materiale

M = Prestare particolare attenzione alle linee guida del produttore degli strumenti/articoli

Prestazioni

Questo prodotto è stato sviluppato, testato e collaudato sui termodisinfettori Getinge per soddisfare gli standard UNI EN ISO 15883.

Getinge Clean

Instrument Lubricant

Un lubrificante per strumenti chirurgici senza silicone impiegato nei termodisinfettori per lubrificare i punti di giunzione degli strumenti e le parti in movimento. Instrument Lubricant non interferisce con i processi di sterilizzazione a vapore o con ossido di etilene.



Istruzioni per l'uso

- Dosaggio: 1–2 ml/l nel risciacquo finale
- Temperatura: >50 °C

Avvertenze

- Non utilizzare su materiale in policarbonato
- Verificare la compatibilità con i materiali prima dell'uso
- Non mescolare con altre sostanze chimiche
- Indossare sempre DPI adeguati

Simboli



Lubrificante Per Strumenti



Strumenti

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Gravità specifica (20 °C): | 0,9 (standard) |
| Viscosità (concentrata, 20 °C): | 24,5 cSt |

Ingredienti

Emulsionanti e olio alimentare minerale o sintetico

Informazioni per lo stoccaggio

Conservare in un luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo, lontano da sostanze acide e forti ossidanti. Conservare il prodotto in posizione verticale nel suo contenitore originale. Temperatura di conservazione ottimale 5–25 °C. Durata di conservazione: 24 mesi in contenitori originali sigillati.

Sicurezza e manipolazione

Fare riferimento alla scheda di sicurezza.

MARCATURA CE

Contrassegnato dal marchio CE in conformità con i requisiti normativi europei vigenti sui dispositivi medici.

Assistenza

Per assistenza tecnica sul corretto utilizzo del detergente, contattare il rappresentante Getinge locale.

Coscienza ambientale

Formulazione biodegradabile e imballaggio riciclabile.

Codice prodotto

| Formato (l) | Lingua | Codice prodotto | Commenti |
|-------------|--------------------------------|-----------------|----------|
| 5 | en, da, fr, es, it, ru, zh, pl | 503436231 | |
| 10 | fr, es, it, pl | 503436331 | |
| 10 | en, da, ru, zh | 503436332 | |
| 25 | fr-es-it-pl | 503436431 | |
| 25 | en-da-ru-zh | 503436432 | |

Compatibilità dei materiali

Consultare sempre le istruzioni per la pulizia fornite dal produttore degli articoli e degli strumenti e verificare la compatibilità con i materiali prima dell'uso. La tabella che segue è puramente indicativa.

| | Alluminio | Alluminio anodizzato | Titanio | Metalli non ferrosi | Cromatura spessa | Acciaio inox | Vetro | Ceramica | Gomma | Plastica |
|---|-----------|----------------------|---------|---------------------|------------------|--------------|-------|----------|-------|----------|
| Getinge Clean Universal Detergent | M | M | M | M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | M |
| Getinge Clean Instrument Lubricant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Getinge Clean Instrument Lubricant Plus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Getinge Clean Pre Treatment Foam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Getinge Clean Enzymatic Detergent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | M |
| Getinge Clean Manual Plus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Getinge Clean MIS Detergent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Getinge Clean Prion Detergent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Getinge Clean Heavy Soil Detergent | - | - | M | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | M |
| Getinge Clean Rinse Aid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | M | M |
| Getinge Clean Chamber Foam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Getinge Clean Neutralizer | M | M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | M | M |
| Getinge Clean Neutralizer Plus | - | - | M | M | M | ✓ | ✓ | M | M | M |

008070

✓ = Il prodotto è adatto per il materiale

- = Il prodotto non è adatto per il materiale

M = Prestare particolare attenzione alle linee guida del produttore degli strumenti/articoli

Prestazioni

Questo prodotto è stato sviluppato, testato e collaudato sui termodisinfettori Getinge per soddisfare gli standard UNI EN ISO 15883.

Getinge Clean

Neutralizer

Un acido organico delicato impiegato nei termodisinfettori per neutralizzare detergenti alcalini e rimuovere dagli strumenti chirurgici il calcare più resistente e altri minerali acido solubili. Il neutralizzatore riduce in maniera efficace il pH dell'acqua di risciacquo a seguito di processi alcalini. Idoneo per tutte le superfici resistenti agli acidi come acciaio inossidabile, ceramica, vetro e plastica.



Istruzioni per l'uso

- Neutralizzazione: dosaggio 1-2 ml/l. Temperatura: 40-60 °C
- Pulizia: dosaggio 1-5 ml/l a temperature >50 °C.
- Assicurarsi di risciacquare bene dopo l'uso

Avvertenze

- Non utilizzare su materiale in policarbonato
- Verificare la compatibilità dei materiali prima dell'uso, poiché tutti i materiali esposti a tale processo devono essere resistenti agli acidi
- Non mescolare con altre sostanze chimiche
- Indossare sempre DPI adeguati

Simboli



Strumenti



Neutralizzatore

deconex® ANTISEPTIC

Dati chimico-fisici

| | | |
|---------|--|--|
| pH | soluzione all'1 % in acqua demineralizzata | ca. 12.0 |
| Densità | Concentrato | 1.43 g/mL |
| Aspetto | Concentrato | da incolore a giallo, da trasparente a leggermente torbido |

Confezionamento

Le confezioni, i tappi e le etichette sono realizzati in polietilene riciclabile.

Dimensioni delle confezioni


| Tipo di contenitore | Contenuto | Codice articolo |
|---------------------|-----------|-----------------|
| Bottiglia | 1 L | 518220.00-F10W |
| Tanica bassa | 5 L | 518220.00-KK5W |
| Tanica | 10 L | 518220.00-K10W |
| Tanica | 25 L | 518220.00-K25W |
| Fusto da 220 L | 200 L | 518220.00-B220 |
| IBC 1000 L | 920 L | 518220.00-IBC1 |

Altre informazioni

La preghiamo di leggere le istruzioni per l'uso e la scheda tecnica sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

Approfitti della nostra competenza! Saremo lieti di fornirle informazioni pratiche per il suo specifico tipo d'impiego.

Produttore:
Borer Chemie AG
Gewerbstrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90
office@borer.ch, www.borer.ch



Dati tecnici

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Gravità specifica (20 °C): | 1,1 (standard) |
| pH tal quale (standard): | 1.2 |
| pH a 5 ml/l di acqua (standard): | 2.2 |
| Viscosità (concentrata, 20 °C): | 6,9 cSt |

Ingredienti

Acido citrico.

Informazioni per lo stoccaggio

Conservare in un luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo, lontano da alcali e forti ossidanti. Conservare il prodotto in posizione verticale nel suo contenitore originale.

Temperatura di conservazione ottimale 5–25 °C. Durata di conservazione: 36 mesi in contenitori originali sigillati.

Sicurezza e manipolazione

Fare riferimento alla scheda di sicurezza.

MARCATURA CE

Contrassegnato dal marchio CE in conformità con i requisiti normativi europei vigenti sui dispositivi medici.

Assistenza

Per assistenza tecnica sul corretto utilizzo del detergente, contattare il rappresentante Getinge locale.

Coscienza ambientale

Formulazione biodegradabile e imballaggio riciclabile.

Codice prodotto

| Formato (l) | Lingua | Codice prodotto | Commenti |
|-------------|--|-----------------|----------|
| 5 | en, sv, da, fr, nl, es, it, tr, ru, zh, ja, el, cs, pl | 503435831 | |
| 10 | sv, da, it | 503435931 | |
| 10 | tr, cs, pl | 503435932 | |
| 10 | fr, es, nl, ja | 503435933 | |
| 10 | en, ru, zh, el | 503435934 | |
| 25 | sv, da, it | 503436031 | |
| 25 | tr, cs, pl | 503436032 | |
| 25 | fr, es, nl, ja | 503436033 | |
| 25 | en, ru, zh, el | 503436034 | |
| 205 | en, sv, da, fr, nl, es, it, tr, ru, zh, ja, el, cs, pl | 503436131 | |

Compatibilità dei materiali

Consultare sempre le istruzioni per la pulizia fornite dal produttore degli articoli e degli strumenti e verificare la compatibilità con i materiali prima dell'uso. La tabella che segue è puramente indicativa.

| | Alluminio | Alluminio anodizzato | Titanio | Metalli non ferrosi | Cromatura opaca | Acciaio inox | Vetro | Ceramica | Gemme | Plastica |
|---|-----------|----------------------|---------|---------------------|-----------------|--------------|-------|----------|-------|----------|
| Getinge Clean Universal Detergent | M | M | M | M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | M |
| Getinge Clean Instrument Lubricant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Getinge Clean Instrument Lubricant Plus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Getinge Clean Pre Treatment Foam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Getinge Clean Enzymatic Detergent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | M |
| Getinge Clean Manual Plus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Getinge Clean MIS Detergent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Getinge Clean Prion Detergent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Getinge Clean Heavy Soil Detergent | - | - | M | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | M |
| Getinge Clean Rinse Aid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | M | M |
| Getinge Clean Chamber Foam | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Getinge Clean Neutralizer | M | M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | M | M |
| Getinge Clean Neutralizer Plus | - | - | M | M | M | ✓ | ✓ | M | M | M |

016073

✓ = Il prodotto è adatto per il materiale

- = Il prodotto non è adatto per il materiale

M = Prestare particolare attenzione alle linee guida del produttore degli strumenti/articoli